

形状変更のお知らせ

歯科麻酔用電動注射筒

オーラスター® 1.0S

オーラスター® 1.8S

(管理医療機器 特定保守管理医療機器)

2017年1月




謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、標記製品について形状を変更いたしますので、ご案内申し上げます。
しばらくの間、新旧製品が市場に流通いたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
今後ともなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

■フロントカバーの形状変更(例:オーラスター1.0S グリーン)

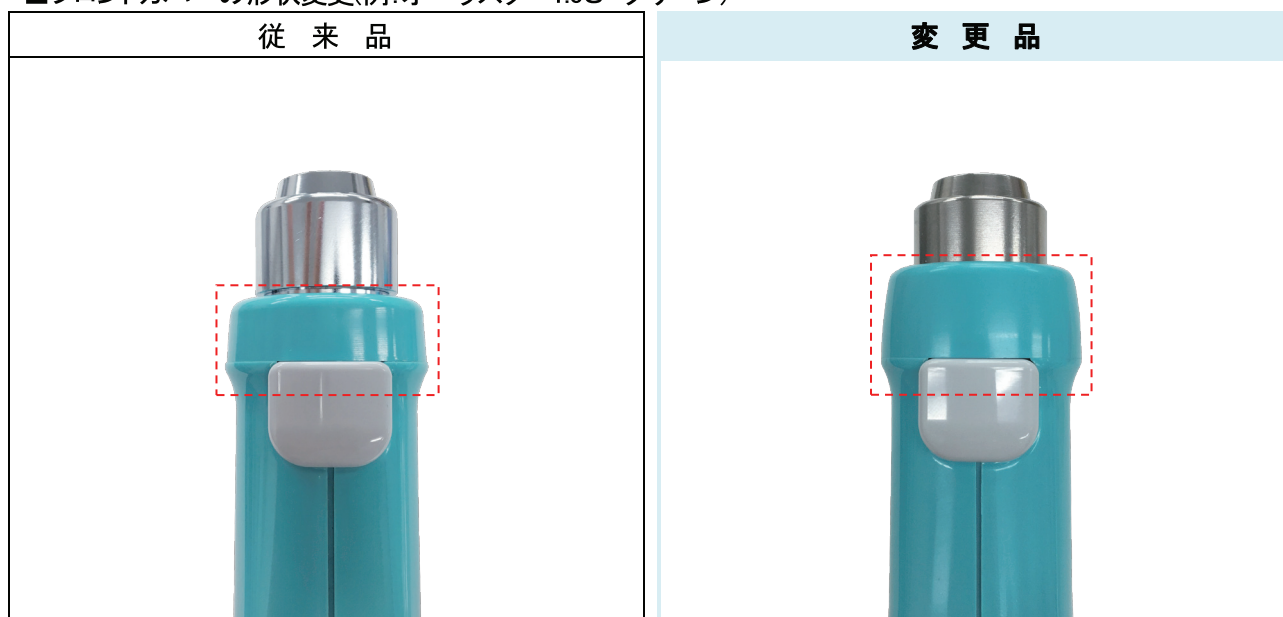

※オーラスター1.0ST、1.8ST は変更品と同様の形状です。

出荷予定時期

販売名	包装	統一商品コード	製造番号		出荷予定時期
			従来品	変更品	
オーラスター1.0S	ラベンダー1台(セット)	094-682205	~6737U1	7051L1~	2017年7月下旬
	グリーン1台(セット)	094-681093	~6580S1	7001K1~	2017年2月下旬
	ピンク1台(セット)	094-681086	~6630S1	7101M1~	2017年9月中旬
オーラスター1.8S	ラベンダー1台(セット)	094-682199	~6499V1	7001K1~	2017年3月上旬
	グリーン1台(セット)	094-681079	~6449U1	7051K1~	2017年2月中旬
	ピンク1台(セット)	094-681062	~6549V1	7101L1~	2017年6月上旬

※統一商品コードは変更ございません。

※流通在庫状況により出荷予定時期に若干の差異が生じることがございますが、ご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

以上

【お問い合わせ先】昭和薬品化工株式会社 TEL:0120-648-914 <受付時間>9:00~17:30(土・日・祝日・弊社休日を除く)