

表示変更のお知らせ

RDテスト「昭和」

2016年5月





謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、標記製品について表示変更いたしますので、ご案内申し上げます。
しばらくの間、新旧製品が市場に流通いたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
本件のご案内が遅れましたことを心よりお詫び申し上げます。
今後ともなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

■ 個装箱の表示変更

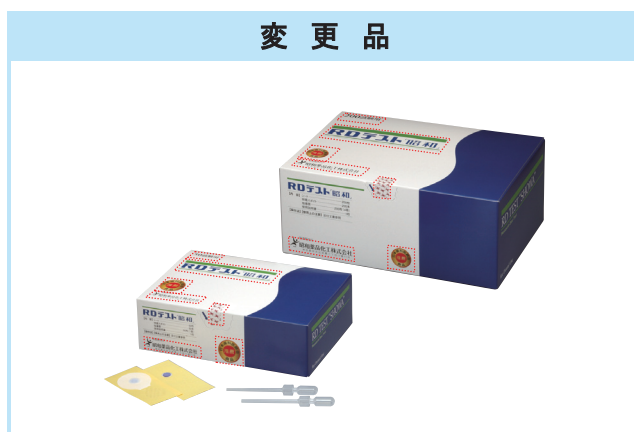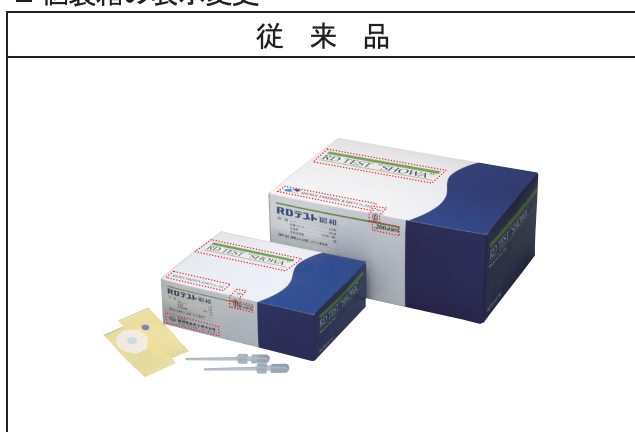

※日本歯科医師会の推薦商品を示すマークを追記いたします。

(2015年8月に日本歯科医師会が定める「歯科衛生製品等の推薦に関する審査基準」により推薦が付与されました。)

※天面の製品名の表記を和名に変更いたします。

※50試験用、200試験用の表示を側面から天面に変更いたします。

※社名ロゴを変更いたします。

※サイズ等の変更はございません。

出荷時期

販売名	包装	統一商品コード	製造番号		出荷時期
			従来品	変更品	
RDテスト「昭和」	50試験用	094-690019	~5081Q	5082T~	2016年2月24日
	200試験用	094-690026	~5081Q	5082T~	2016年3月7日

※統一商品コードは変更ございません。

※流通在庫状況により出荷予定時期に若干の差異が生じることがございますが、ご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

以上